

PRELUDE

ENEMA BULB KIT



USER GUIDE


사용 전 설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.

Prelude는 다양한 범위의 직장 세척을 가능케 하여 새로운 관장세척의 방법을 선보이는 제품입니다.

기존의 세척용품이 가지고 있던 지나치게 강한 분사력이나, 분출 후 공기가 들어가는 문제를 **Prelude**는 특별한 단방향 저속 노즐로 해결하여, 관장기구에 담긴 물의 흐름을 느리게 함과 동시에 기구 내부로 공기가 들어가는 현상을 방지합니다.

이 노즐은 또한 삽입 중 액체 역류를 방지하는 설계로 만들어져 안전하고 위생적인 사용이 가능합니다. 작은 용량으로도 세척이 가능할까 의구심이 들 수도 있습니다만, 과도한 용량으로 세척을 하는 경우 내부 장기에 부담이 되어 세척이 더욱 어려워지므로, 작은 용량으로 세척을 하는 것이 최적의 선택이 됩니다. 또한 액체가 분출되는 속도를 늦추어 갑작스러운 관장으로 인한 부담을 받지 않고 더욱 쉽게 신체를 컨트롤 할 수 있습니다.

아네로스 삽입 전 관장은 장 전체를 세척하는 것이 아닌 직장 부분을 세척하는 것이 목적이므로, **Prelude**는 관장에 있어 가장 쉽고 빠르며 편안한 도구가 될 것입니다.

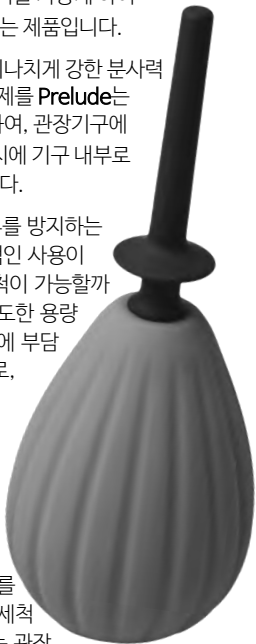

처음 사용하기 전에


관장을 시작하기 전, Prelude의 내외부를 미온수와 액체비누 또는 중성세제로 세척하세요.

사용방법



Prelude에는 반드시 물만 사용하세요!


체온과 가장 비슷한 온도의 물을 Prelude에 채워주세요. 너무 차갑거나(32도 미만) 뜨거운 물(40도 초과)을 사용하면 직장이 과도하게 긴장될 수 있습니다.



노즐 마개부분(관장기 본체에 삽입되는 부분)의 삽입구가 적당히 젖은 듯한 느낌으로 약간의 수용성 윤활제를 도포해주세요. (오일 및 실리콘 윤활제는 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 됩니다.)



Prelude 본체에 물을 넣은 상태에서 한손으로는 노즐 큰 손잡이 부분을, 다른 한손으로는 본체를 잡아 천천히 노즐을 삽입합니다. 이때 본체에 너무 힘을 줘 물이 빠져나가지 않도록 주의하세요. 이어 탁 하는 소리와 함께 본체와 노즐이 연결됩니다.



연결 후, 노즐을 살짝 회전시켜 빈틈없이 밀폐시킵니다. 노즐 끝 부분에 적당량의 윤활제를 도포하여 사용하세요. (노즐 큰 손잡이 부분은 연결 해제시 사용해야 하므로 되도록 도포하지 말아주세요.) 이제 Prelude를 사용할 준비가 되었습니다.

PRELUDE 사용하기

Prelude는 약 295ml의 물을 채울 수 있습니다. 이 용량으로 한번에 많은 양의 관장 또는 4번에 걸친 소량의 직장세척이 가능합니다. 소량의 물을 사용하면 직장 내 이물질을 간편히 제거하면서도 갑작스러운 자극에 직장이나 장이 수축되는 현상을 방지합니다. 이 방법을 사용하고 싶다면, 60~90ml(Prelude의 약 3분의 1)의 물을 사용하는 것으로 시작해보세요. 사용자의 선호하는 방법에 따라 한번에 많은 양의 물을 사용하는 전통적인 방식을 사용하셔도 좋습니다. 정확한 사용을 위해, 노즐은 항문에 최소한 5cm정도에서 최대 노즐 손잡이 부분 전까지는 삽입되어야 합니다. 노즐 손잡이를 이용해 삽입된 정도를 가늠하실 수 있으며, 노즐 전체가 삽입되는 것을 방지할 수 있습니다.

절대로 노즐 손잡이를 포함한 노즐 전체가 삽입되지 않도록 주의하세요. 과도한 삽입 시, 노즐이 직장 내에서 본체와 분리 될 수 있습니다.

관장 및 재사용

Prelude 본체를 눌러보면 기존 관장기보다 더 저항력이 있는 느낌을 받으실 겁니다. 대부분의 관장기는 1~2초만에 내용물이 분출되지만, Prelude는 내용물을 비우는데에 30~40초가 소요됩니다. 이는 내용물이 천천히 분출되는 저속 노즐이 정상적으로 작동되는 것을 의미합니다.

이에 따라, 많은 양의 물이 들어가면서 느껴지던 압박감이 이 제품을 사용하시면 잘 느껴지지 않을 것입니다. 이 또한 의도된 기능입니다. 얼마정도의 물을 사용하였는지는 관장기 본체의 줄어듦 정도를 통해 확인하실 수 있습니다. 손으로 본체를 만지면서 가늠하시거나 관장을 잠시 멈추고 노즐을 항문에서 제거해 직접 관장기를 보면서 확인하세요.

사용 중이던 관장기를 보시면, 내부에 공기가 들어가지 않아 다시 부풀지 않는 것을 확인하실 수 있습니다. 이에 따라, 체내에 공기가 들어가는 현상을 방지하고, 직장에서 물을 제거하지 않고 바로 관장을 재개하실 수 있습니다. 필요하다면 재삽입시 노즐에 윤활제를 다시 도포해주세요.


세척하기



검지와 중지를 포크처럼 하여 노즐 손잡이 밑을 잡습니다. 다른 손으로 본체를 잡아 노즐이 분리될 때까지 힘껏 당기세요. 이렇게 하면 삽입되었던 부분을 건드리지 않고 노즐을 분리할 수 있습니다.



액체비누와 미온수를 이용해 Prelude의 본체와 노즐의 외관부터 세척하세요.



내부세척을 위해, 본체 내부에 액체비누를 몇 방울 정도 주입하고 제품의 반 정도를 미온수로 채웁니다. 노즐을 본체와 연결할 때, 이미 액체비누를 주입하였으므로 윤활제는 사용하지 않으셔도 됩니다. (계속)

세척하기 (계속)



본체를 힘껏 흔들어주세요. 노즐 세척 시, 노즐 끝을 꼭 집은 다음 본체를 쥐어 주면 노즐 밸브가 열려 비눗물이 잘 흐르게 됩니다. 노즐을 본체에서 분리하여 노즐과 본체 모두 잘 씻어주세요. 극세사천으로 툭툭 두드리며 물기를 제거한 다음,

본체 구멍을 밑으로 하여 건조대나 페이퍼타올 위에 두어, 내부까지 전부 건조된 후 보관합니다.

노즐 내부가 파손될 수 있으므로, 노즐 안에는 어떠한 것도 삽입하지 마세요. 강력한 화학제품이나 용매는 실리콘을 손상시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.

주의사항

Prelude는 의료기기가 아니며 변비, 분변매복 또는 기타 의학적 상태에 대한 치료용으로 사용해서는 안 됩니다. 만약 이러한 문제를 가지고 있거나 일반적인 건강 상태에 대해 우려되는 경우, 이 제품을 사용하기 전 의사와 상의하십시오. 붓기, 염증, 화상 및 피부가 손상된 신체 부위에 Prelude를 사용하지 마십시오. Prelude를 사용 시 반드시 충분한 양의 윤활제를 같이 사용하십시오. 충분치 않은 양의 윤활은 불편함, 고통 또는 항문 손상을 유발할 수 있습니다. 절대로 Prelude의 노즐과 본체를 전부 체내로 삽입하려 시도하지 마십시오. Prelude의 노즐 손잡이는 삽입된 정도를 가늠하고 노즐 전체가 삽입되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 노즐 전체가 삽입되어 본체와 분리된 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. (계속)

주의사항 (계속)

불편함, 통증, 붓기, 고통, 출혈 또는 감각 상실이 있는 경우 사용을 중단하십시오. 알코올이나 약물에 취한 상태에서는 판단력 저하 및 부상의 위험이 있으므로 이 제품을 사용하지 마십시오. 삽입하기 전 마취연고 및 스프레이를 사용하지 마십시오. 이는 통증이나 불편함에 대한 인식을 저해하여 부상을 감지하는 데에 영향을 끼칠 수 있습니다. 다음과 같은 증상이 있는 경우 이 제품을 사용하기 전 의사와 상의하십시오; 활동성 크론병, 활동성 궤양성 대장염(UC), 염증성 장질환(IBD), 염증성 장증후군(IBS), 직장 또는 항문 출혈. 이 제품을 사용할 때 합병증이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사의 진찰을 받으십시오. 병원균의 전염 위험을 방지하기 위해, 절대로 타인과 Prelude를 공유하지 마십시오.

면책사항: 아네로스의 사용은 사용자의 판단과 책임에 따릅니다. 아네로스의 제조사나 판매자는 아네로스 사용으로 인해 발생하는 어떠한 결과에도 책임을 지지 않습니다. 사용 중 통증이 있거나 불편함을 느끼신다면 사용을 중지하시기 바랍니다.



ANEROS.COM